



Votre partenaire au bloc opératoire
OPX mobilis® – Tables d'opération



A Sense of Company

Forte plus de de 90 ans d'expérience, l'entreprise SCHMITZ a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de l'entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos valeurs et à la philosophie de l'entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant la 4^e génération, ont repris les rênes de l'entreprise.


Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande et sommes bien ancrés dans notre région d'origine. Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands et provenant à 60 % de la région.

Made in Germany



'La transmission à la nouvelle génération a toujours été et restera toujours un grand événement chez nous.'

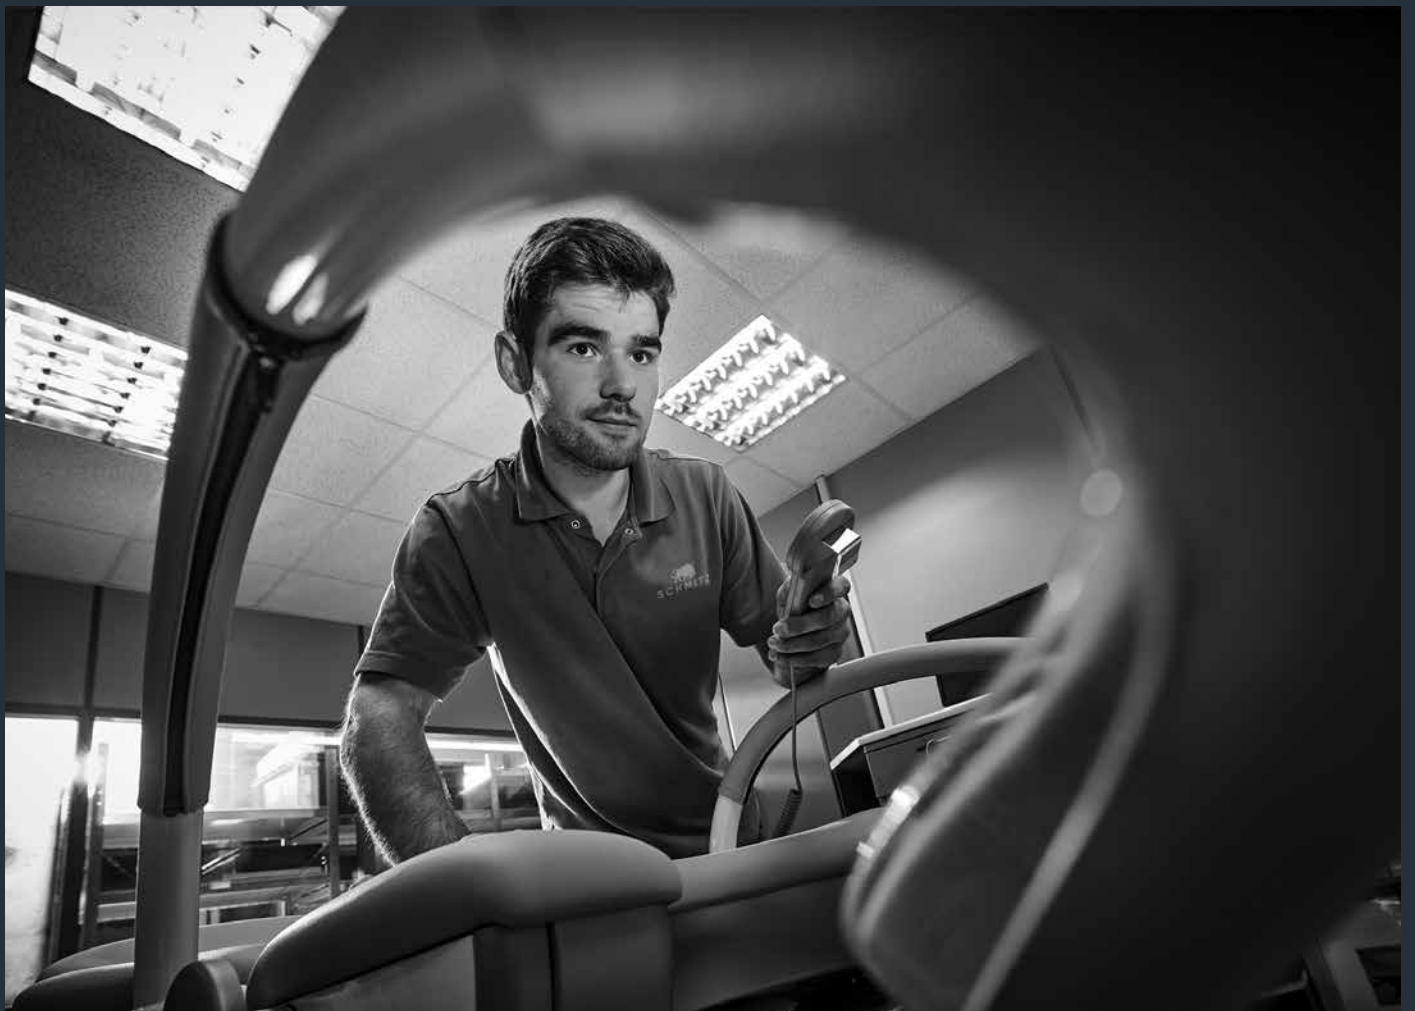

A Sense of Care

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu'à la mise en place en passant par la planification.


Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n'est pas tout : un concept de service bien pensé et un accompagnement après achat très complet. Dès le début, SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d'assistance technique client

tél. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com

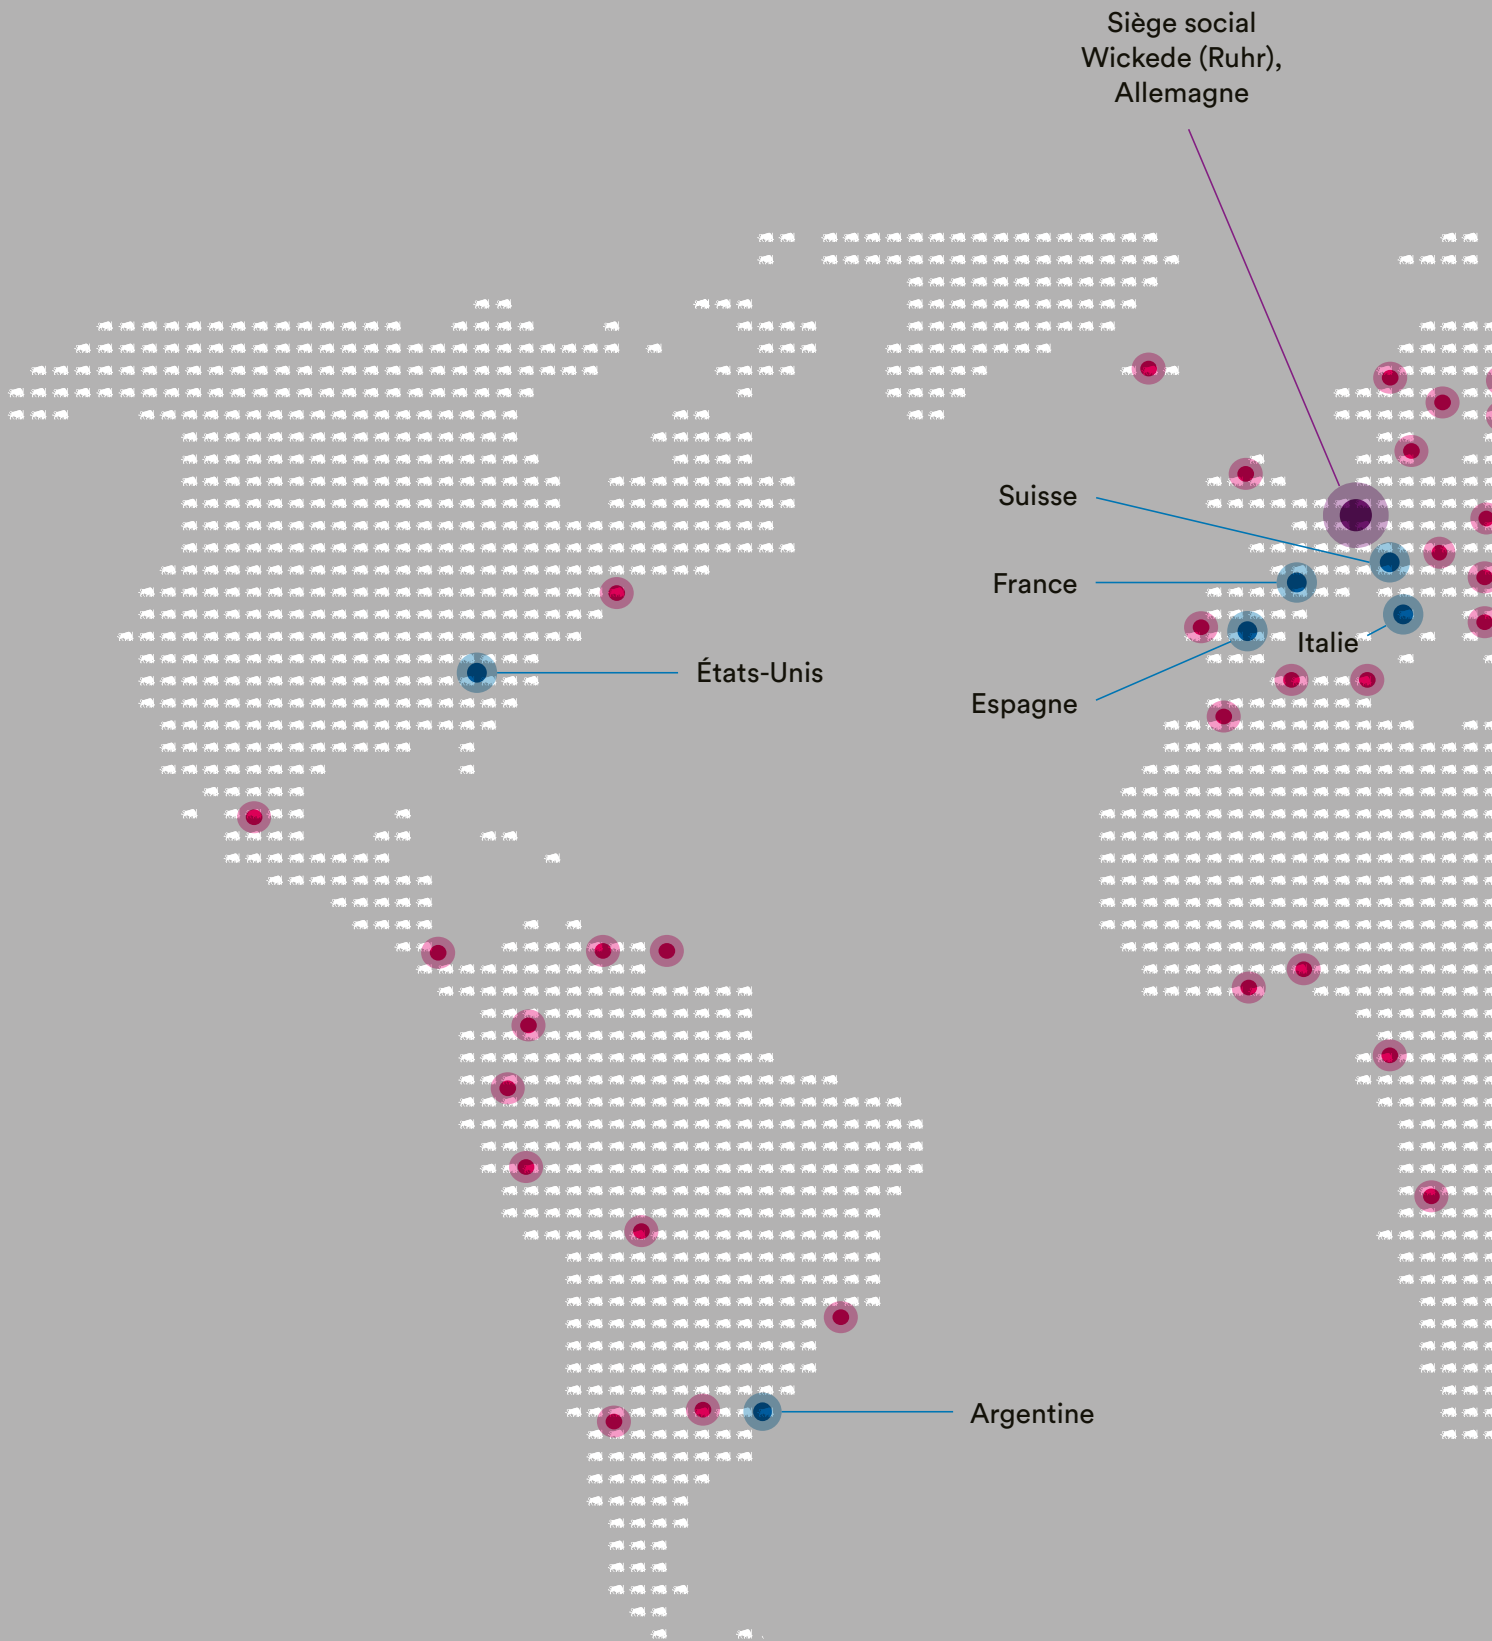

● plus de 80 partenaires internationaux

● succursales

SCHMITZ – représenté partout dans le monde





OPX mobilis® CE^{MD}

La table d'opération polyvalente

Utilisation fonctionnelle

Son concept d'utilisation facilement compréhensible et sûr permet un réglage des positions ultra simple et indépendant. Usage universel, flexibilité et polyvalence.

Confort et prévention

Dotée de coussins et matelas à mémoire de forme, la table d'opération offre un confort maximal au patient et permet de prévenir efficacement les escarres.

Une mobilité universelle

La table d'opération présente un châssis robuste vous assurant une parfaite maîtrise de sa mobilité et une manipulation nécessitant peu d'efforts – un gage de sécurité supplémentaire.

Facile d'entretien et hygiénique

Conçue selon notre approche globale de l'hygiène, la table d'opération offre des conditions d'hygiène optimales au bloc opératoire grâce à des coussins au gel autoadhésifs.

Usage universel, flexibilité et polyvalence

Qu'elle soit à réglage manuel ou électrohydraulique, la table d'opération mobilis dispose d'un large éventail d'accessoires la rendant universelle et polyvalente : elle sera toujours adaptée à vos besoins et méthodes de travail.





Dispositif de roulement



Override manuel

Commande manuelle

IEC		TECEE		Ref. Certif. No.
				DE1-62305
<p>AN SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST PROCEDURES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (2004) (IEC 61010)</p>				
<p>CB TEST CERTIFICATE</p>				
Product	<p>Schmitz a - Simec GmbH & Co. KG Zorn Dohrstedt 28, 58738 Wittenau (Rhein- land) GERMANY</p>			
Name and address of the applicant	<p>Schmitz a - Simec GmbH & Co. KG Zorn Dohrstedt 28, 58738 Wittenau (Rhein- land) GERMANY</p>			
Name and address of the manufacturer	<p>Schmitz a - Simec GmbH & Co. KG Zorn Dohrstedt 28, 58738 Wittenau (Rhein- land) GERMANY</p>			
Name and address of the factory	<p>Schmitz a - Simec GmbH & Co. KG Zorn Dohrstedt 28, 58738 Wittenau (Rhein- land) GERMANY</p>			
Year when manufacturing under permanent control	<p>□ Antenna Information on page 3</p>			
Temperatures and principal characteristics	<p>Electrically powered: DC 24 V, 2 A Safety charger: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1.2 A</p>			
Trademark of energy	<p></p>			
Customer's Training Facility (CTF) design code	<p>DPX mobilis R 200, DPX mobilis R 200 DPX mobilis R 40 30, DPX mobilis R 40 40 mobile followed by suffix "L", "M", "C", "S" or "H"</p>			
Model / Type No.	<p>□ Antenna Information on page 3</p> <p>IEC 60950-1:2009 IEC 60950-1:2009/AM1:2012 IEC 60950-1-4:2016 IEC 60950-1-4:2016/AM1:2012 IEC 60950-1-4:2016</p>			
Additional information (if necessary only refer to separate page 2)	<p>280144 FLA-n, 280144 FLA G, 280144 FLA-3</p>			
A sample of the product was tested and found to be in conformance with	<p>The CB Test Certificate is issued by the National Certification Body</p>			
As shown in the Test Report Ref. for which tests were carried out by this Certificate	<p>VDE - Institut für Zulassungsprüfungen und Zertifizierung VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungsstelle und nationaler Angabegestaltung Certification Body and national Address</p>			
Date: 2025-05-28	<p>Signature </p>			

OPX mobilis® C€^{MD}

Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Commande manuelle

pour l'actionnement des fonctions électrohydrauliques de la table. La commande manuelle est munie d'un affichage de l'état de charge des batteries ainsi qu'une touche d'activation qui pour éviter d'actionner involontairement une fonction. La fonction « Mode d'inversion » permet le positionnement correct de la table quand le patient est positionné en position inverse sur le plateau opératoire. Les touches rétroéclairées servent au réglage aisé et en toute sécurité même dans une salle d'opération assombrie. La commande manuelle peut être munie, en option, d'une touche de fonction de retour à zéro.

Override manuel

Les réglages de la table peuvent se faire par commande électrique mais également par commande manuelle à l'aide d'un levier de présélection et d'une pompe hydraulique – votre équipement est prêt à l'emploi à tout moment !

Dispositif de roulement

4 doubles roulettes à déplacement facile avec couverture, blocage central au moyen d'une pédale. 1 roulette directionnelle à ressorts pouvant être mise en service au moyen d'une pédale (selon le modèle).

La sécurité a été vérifiée selon la procédure CB

conformément à CEI 60601 par un organisme de contrôle allemand indépendant et autorisé.



OPX mobilis® C€^{MD}

Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Chargeur de batteries

Pour les tables à commande électrohydraulique, petit et pratique. Insensible aux endommagements, avec fiche selon la norme CEI 60320 et câble de réseau. Charge d'entretien des batteries.

Pour une tenue optimale des coussins


de rembourrages à leur place, une fixation au moyen d'un gel autocollant est utilisée. Ce gel autocollant résiste à la désinfection

Coussins à mémoire de forme

garantissant la prophylaxie anti-décubitus (risque d'escarre) et, en même temps, un confort élevé pour le patient.

Enlèvement de la tête et des plateaux de jambes par simple pression

L'échange simple de la tête et des plateaux de jambes permet un positionnement du patient en Reverse Mode. La mise en place sans problème des éléments de la table est rendue possible par des fixations de sécurité.



OPX mobilis® C €^{MD}**Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité****Option :**

traverse en fibres de carbone située à la partie dorsale, radiotransparente.

Rails continus

pour l'introduction des cassettes radiographiques.

Panneau de distribution

pour le raccordement du cordon électrique, prise d'équipotentialité. Interrupteur principal et écran pour l'affichage des informations du statut de la table.

Roulettes avec carters de protection contre des liquides**Translation longitudinale**

du plateau de la table (modèles L) par 250 mm au total.







OPX mobilis® 200 / 300 C€^{MD}

Les tables d'opération légères et maniables : Opérer sans dépendre du lieu ou de l'alimentation en énergie

Une commande précise à tout moment

Levier de présélection inclinable pour tous les mouvements du modèle utilisé, déclenchement facile au pied via le levier de la pompe.

Coussin doux en mousse visco-élastique amovible

Des coussins à mémoire de forme de qualité aident à installer correctement le patient et permettent d'éviter l'apparition des escarres. Ils permettent de décharger la pression, sont imperméables aux liquides et conducteurs. Fixation facile à la table grâce à une bande adhésive en gel.

Très grande stabilité dans la direction et bonne manœuvrabilité

Permet de prendre des virages serrés et de parcourir de longs couloirs avec seulement un minimum de force. Son secret : quatre roulettes doubles à déplacement fluide avec blocage centralisé par pédale. Pour plus de stabilité, le dispositif dispose d'une roulette directionnelle suspendue (en fonction du modèle).

Des conditions hygiéniques optimales au bloc

Des surfaces closes faciles à nettoyer, une fermeture hygiénique grâce à un pied en forme de bac ainsi que des bandes adhésives en gel pour fixer les coussins résistantes aux désinfectants. Et ce ne sont ici que quelques-uns des aspects de la mobilis qui vous aideront à bien mettre en œuvre votre plan hygiène.

Translation longitudinale de la tablette

Au total, la tablette peut coulisser sur 250 mm (en fonction des modèles), afin de permettre une radio-transparence optimale avec l'amplificateur de brillance.

OPX mobilis® CE^{MD}

Modèles de base

N° modèle	Description
-----------	-------------



161.2010.1	mobilis 200
-------------------	--------------------

	Table d'opération hydraulique à deux fonctions : Réglage en hauteur, Déclive/Proclive. Réglage de la partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques. La table est mobile sur 4 roulettes doubles, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale à pied. (sans repose-tête/plateaux de jambes)
--	---



N° modèle Description

161.3110.1 mobilis 300 C

Table d'opération hydraulique à pompe à pédale pour les 3 fonctions : élévation/abaissement, latéral, proclive/déclive. Réglage de la partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques. Mobile sur 4 roulettes doubles avec carters, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 5e roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)



161.3210.1 mobilis 300 CL

Identique au modèle 300 C, avec toutefois en plus : translation longitudinale manuelle du plateau supérieur de la table de 250 mm au total pour permettre une radiographie optimale du patient moyennant l'amplificateur d'images.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)



OPX mobilis® 200/300 C €^{MD}

Equipement de série

Plateau opératoire en 2 parties, radiotransparent ; se composant de :

- partie dorsale
- siège avec découpe gyn.
(en option, également sans découpe gyn.)

Réglages hydrauliques :

- élévation/abaissement
- déclive/proclive
- latéral (modèles mobilis 300)

Actionnement par levier de présélection (avec affichage visuel de la fonction sélectionnée au niveau de la construction d'embase) et également par la pompe à pédale.

Réglage de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique. Tunnel pour cassettes intégré. Surfaces du plateau opératoire avec matelas SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable, grenailé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants. Rails latéraux en acier inox, 25 × 10 mm, des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation d'accessoires, colonne à revêtement en acier inoxydable.


Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs. La table est mobile sur 4 doubles roulettes (125 mm de diam.), dont 2 antistatiques, avec carter, blocage central au moyen d'une pédale, 5e roulette directionnelle à ressorts, peut être actionnée au moyen d'une pédale (modèles mobilis 300).



OPX mobilis® 200/300 C €^{MD}

Equipement de base

N° modèle Description



101.2580.1 **Repose-tête**
inclinable, réglable d'une seule main et assisté par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.



101.2590.1 **Repose-tête**
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.




101.2170.1 **Plateau de jambes divisé**
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.



101.2180.1 **Plateau de jambes**
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.


Pour plus d'accessoires, voir le catalogue no. 92.

mobilis 200, 300 C




Réglage en hauteur


mobilis 300 CL




Réglage en hauteur




Longueur totale

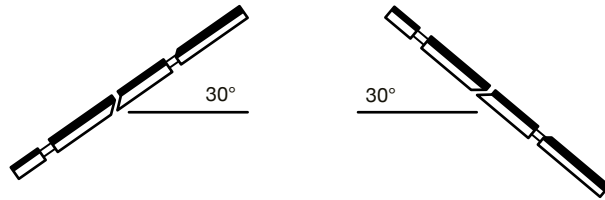

Déclive/Proclive



Dossier




Dossier


Modèles mobilis 300




Latéral



Largeur du plateau opératoire



Reflex



Flex

OPX mobilis® 200/300 C €^{MD}

Fonctions de réglage et dimensions

Données techniques	mobilis 200	mobilis 300 C	mobilis 300 CL
Longueur totale sans repose-tête/ plateaux de jambes	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Longueur totale sans repose-tête, mais avec plateaux de jambes	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Longueur totale avec repose-tête/ plateaux de jambes	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Largeur de plateau opératoire	540 mm	540 mm	540 mm
Largeur totale	590 mm	590 mm	590 mm
Plaque de base (longueur x largeur)	1.120 x 580 mm	1.120 x 580 mm	1.120 x 580 mm
Diamètre des roulettes	125 mm	125 mm	125 mm
5 ^e roulette directionnelle	—	■	■
Réglage en hauteur (sans matelas)	690 – 1.050 mm	690 – 1.050 mm	720 – 1.080 mm
Déclive, réglage hydraulique	30°	30°	30°
Proclive, réglage hydraulique	30°	30°	30°
Réglage latéral réglage hydraulique	—	+/- 20°	+/- 20°
Translation longitudinale du plateau supérieur	—	—	250 mm
Inclinaison de la partie dorsale	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°
Inclinaison des plateaux de jambes	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Ecartement des plateaux de jambes	180°	180°	180°
Inclinaison du repose-tête	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angle d'inclinaison de rembourrage du repose-tête	25°	25°	25°
Poids net (env.) avec repose-tête/ plateaux de jambes	160 kg	180 kg	190 kg
Capacité de charge ² : Charge statique maximale	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg
Charge maximale d'utilisation	jusqu'à 185 kg	jusqu'à 185 kg	jusqu'à 185 kg

■ = équipement de série

² La capacité de charge peut varier en fonction de l'orientation et de la position du patient.



OPX mobilis® RC CE^{MD}

Confort et fiabilité dans la chirurgie

Commande manuelle

pour sélection directe de la fonction souhaitée

Affichage de l'état de charge des batteries

Touche d'activation

pour éviter l'actionnement involontaire d'une fonction

Les touches de commande rétroéclairés

servent au réglage aisé et en toute sécurité même dans une salle d'opération assombrie

Mode d'inversion

inversion des fonctions lorsque le patient est installé en position inverse

Position 0 optionnelle

la table est remise automatiquement dans la position de départ en appuyant sur la touche

Override manuel – à deux sécurités

à part du réglage électrique, possibilité de réglage manuel de toutes les fonctions de la table au moyen d'un levier de présélection et d'une pompe hydraulique

Pédale à 3 fonctions

pour déplacement en ligne droite, mobilisation et blocage central

Réglage de la partie dorsale

réglage électrohydraulique de la partie dorsale par la commande manuelle ou au moyen de la pompe hydraulique (en fonction du modèle)

OPX mobilis® RC

Modèles de base



N° modèle Description

161.3510.1 mobilis RC 30

Table d'opération universelle avec réglage électro-hydraulique au moyen d'une télécommande manuelle pour les 3 fonctions de la table :
élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive.
Possibilités supplémentaires de réglage hydraulique de ces fonctions au moyen d'une pompe à pédale. Réglage de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique.
Batteries rechargeables. Chargeur séparé avec entrée de tension de 100 V à 240 V et câble d'alimentation.
Mobile, sur 4 doubles roulettes avec carter, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 1 roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale. **(sans repose-tête/plateaux de jambes)**



N° modèle Description

161.3610.1 mobilis RC 30 L

Identique au modèle RC 30, mais en supplément :
possibilité de translation longitudinale manuelle
du plateau supérieur de table de 250 mm au total,
afin de radiographier le patient de façon optimale
avec l'amplificateur d'images.

101.0225.0 Fonction de remise à zéro

(sans ill.) pour modèles RC 30, pas de post-montage.

OPX mobilis® RC CE^{MD}

Modèles de base



N° modèle	Description
-----------	-------------

161.4510.1	mobilis RC 40
-------------------	----------------------

Table d'opération universelle avec réglage électro-hydraulique pour les 4 fonctions de la table : élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive, partie dorsale. Possibilités supplémentaires de réglage hydraulique de ces fonctions au moyen d'une pompe à pédale. Batteries rechargeables. Chargeur séparé avec entrée de tension de 100 V à 240 V et câble d'alimentation. Mobile, sur 4 doubles roulettes avec carter, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale, 1 roulette directionnelle à suspension, mise en service par pédale. **(sans repose-tête/plateaux de jambes)**



N° modèle Description

161.4610.1 mobilis RC 40 L

Identique au modèle RC 40, mais en supplément :
possibilité de translation longitudinale manuelle
du plateau supérieur de table de 250 mm au total
(avant/arrière), afin de radiographier le patient de
façon optimale avec l'amplificateur d'images.

101.0226.0 Fonction de remise à zéro

(sans ill.) pour modèles RC 40, pas de post-montage.



OPX mobilis® RC

Equipement de série

Plateau opératoire en 2 parties,
radiotransparent ; se composant de :

- partie dorsale
- siège avec découpe gyn.
(en option, également sans découpe gyn.)

Réglages électrohydrauliques :

- élévation/abaissement
- déclive/proclive
- latéral
- dorsal (modèles RC 40)

Override manuel :

option de réglage indépendant de la fonction sélectionnée au moyen du levier de présélection et de la pompe à pédale.

Réglage de la partie dorsale assisté par vérins pneumatiques (modèles RC 30)
Tunnel pour cassettes intégré. Surfaces du plateau opératoire avec matelas SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable, grenailé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants. Rails latéraux en acier inox, 25 x 10 mm, des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation d'accessoires, colonne à revêtement en acier inoxydable.

Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs. La table est mobile sur 4 doubles roulettes antistatiques avec carters, dont 2 antistatiques, blocage central au moyen d'une pédale, 5e roulette directionnelle à ressorts, peut être actionnée au moyen d'une pédale.

Batteries rechargeables. Chargeur de batteries séparé avec câble d'alimentation.

A noter svp :


Le chargeur de batteries peut être opéré à une tension de secteur de 100 à 230 V et à une fréquence de 50 à 60 Hz. Il est muni d'une prise femelle qui conforme à la norme CEI-60320.



OPX mobilis® RC CE^{MD}

Equipement de base

N° modèle Description



101.2580.1 **Repose-tête**
inclinable, réglable d'une seule main et assisté par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.



101.2590.1 **Repose-tête**
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.




101.2170.1 **Plateau de jambes divisé**
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.



101.2180.1 **Plateau de jambes**
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage par vérins pneumatiques, amovible par simple pression des boutons.


Pour plus d'accessoires, voir le catalogue no. 92.

RC 30, RC 40




Réglage en hauteur


RC 30 L, RC 40 L




Réglage en hauteur




Longueur totale



Déclive/Proclive




Dossier




Dossier




Latéral



Largeur du plateau opératoire



Reflex



Flex

OPX mobilis® RC

Fonctions de réglage et dimensions

Données techniques	RC 30	RC 30 L	RC 40	RC 40 L
Longueur totale sans repose-tête/ plateaux de jambes	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Longueur totale sans repose-tête, mais avec plateaux de jambes	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Longueur totale avec repose-tête/ plateaux de jambes	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Largeur de plateau opératoire	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Largeur totale	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Plaqué de base (longueur x largeur)	1.120 mm x 580 mm	1.120 mm x 580 mm	1.120 mm x 580 mm	1.120 mm x 580 mm
Diamètre des roulettes	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
5° roulette directionnelle	■	■	■	■
Réglage en hauteur (sans matelas) ³	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Déclive ³	30°	30°	30°	30°
Proclive ³	30°	30°	30°	30°
Réglage latéral ³	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Translation longitudinale du plateau supérieur	—	250 mm	—	250 mm
Inclinaison de la partie dorsale	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°	+ 75/- 50° ³	+ 75/- 50° ³
Inclinaison des plateaux de jambes	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Ecartement des plateaux de jambes	180°	180°	180°	180°
Inclinaison du repose-tête	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angle d'inclinaison de rembourrage du repose-tête	25°	25°	25°	25°
Poids net (env.) avec repose-tête/ plateaux de jambes	210 kg	220 kg	215 kg	225 kg
Capacité de charge ² :				
Charge statique maximale	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg	jusqu'à 250 kg
Charge maximale d'utilisation	jusqu'à 185 kg	jusqu'à 185 kg	jusqu'à 225 kg	jusqu'à 225 kg
Fonctionnement par batteries	■	■	■	■

■ = en série

² La capacité de charge peut varier en fonction de l'orientation et de la position du patient.

³ Réglage électrohydraulique

OPX mobilis® C€^{MD}

Equipement en accessoires recommandé

Chirurgie générale

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0019.0	Appui-bras
101.0123.0	Fixe-poignet
101.0177.1	Fixe-corps
101.0012.0	Arceau d'anesthésie
101.0111.0	Rallonge

Chirurgie vasculaire

N° modèle	Description
OPX mobilis® RC 40 L sans échancrure gynécologique	
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0019.0	2 x Appui-bras

Procédures proctologiques

N° modèle	Description
1. en pos. de lithotomie :	
101.2580.1	Repose-tête
101.0115.0	2 x Appuis-jambes de Göpel
101.0146.0	2 x Étaux
101.0019.0	2 x Appui-bras
101.0010.0	Appui-épaules (1 paire)

2. en décubitus ventral :

101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes sans échancrure gyn.
101.0019.0	2 x Appui-bras
101.0682.0	Plateaux supports pour les genoux et les pieds (paire)
101.0107.1	2 x Support latéral
101.0178.0	Rouleau de rectoscopie
101.0146.0	2 x Étaux
101.0012.0	Arceau d'anesthésie

Chirurgie invasive minimale/ Laparoscopie

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0019.0	Appui-bras
101.0123.0	Fixe-poignet
101.0164.0	2 x Fixe-jambes
101.0012.0	Arceau d'anesthésie
101.0111.0	Rallonge

optionnellement :

101.0115.0	2 x Appuis-jambes de Göpel
101.0146.0	2 x Étaux

alternativement aux 101.0115.0/101.0146.0

101.0678.0	Appui-jambes UniLeg (paire)
------------	--------------------------------

Chirurgie rénale/Thoracique

N° modèle	Description
OPX mobilis® modèle « L » (Charge max. d'utilisation : max. 225 kg)	
101.2590.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0352.0	Tunnel pad with Kgel protection
101.0121.0	3 x Supports universels
101.0162.0	2 x Supports dorsaux/ fessiers
101.0175.0	Support de pubis

Gynécologie

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0115.0	2 x Appuis-jambes de Göpel
101.0146.0	2 x Étaux
101.0019.0	Appui-bras
101.0123.0	Fixe-poignet
101.0012.0	Arceau d'anesthésie
101.0111.0	Rallonge

alternativement :

101.4010.1 Adaptateur court

Urologie/TUR

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.6010.1	Adaptateur long
101.0182.0	Cuvette orientable
101.0191.0	Crépine RTU
101.0115.0	2 x Appuis-jambes de Göpel
101.0146.0	2 x Étaux
101.0019.0	Appui-bras
101.0123.0	Fixe-poignet
101.0012.0	Arceau d'anesthésie
101.0111.0	Rallonge

**alternativement aux
101.0115.0/101.0146.0**

101.0678.0 Appui-jambes UniLeg
(paire)

OPX mobilis® CEMD

Equipement en accessoires recommandé

ORL/CMF

N° modèle Description

1. Modèle de table sans échancrure gyn.

101.2580.1 Repose-tête
101.0332.0 Donut head pad
101.2180.1 Plateau de jambes

2. Positionnement en Reverse mode, au lieu du plateau de jambes

101.2720.0 Adaptateur universel
101.0363.0 Pièce intermédiaire
101.0179.0 Calotte de tête

3. Positionnement en Reverse mode, au lieu du plateau de jambes

101.2780.1 Plateau dorsal
101.0363.0 Pièce intermédiaire
101.0179.0 Calotte de tête

en plus, pour les trois variantes :

101.0019.0 2 x Appuis-bras
101.0177.1 Fixe-corps

Ophthalmologie

N° modèle Description

Position inversée du patient modèle de table « L » sans échancrure gyn.

101.2180.1 Plateau de jambes
101.0019.0 Appui-bras
101.2780.1 Plateau dorsal
101.0256.0 Calotte de tête avec réglage à une main

alternativement :

101.2720.0 Adaptateur universel
101.0256.0 Calotte de tête avec réglage à une main

Traumatologie – traitement de fractures du bras

N° modèle Description

101.2580.1 Repose-tête
101.2170.1 Plateaux de jambes
101.0136.0 Dispositif de positionnement de l'humérus
101.0146.0 Étau
101.0152.0 Barre de contre-extension de l'humérus
101.0146.0 Étau
101.0163.1 Fixe-poignet de Weinberger

en décubitus ventrale :

101.0122.0 Support humérus
101.0117.0 Étau

traitement de fractures de l'avant-bras :

101.0257.0 Support d'aisselle
101.0258.0 Support de l'articulation du coude

Arthroscopie de l'épaule

N° modèle	Description
position Beach Chair :	
101.2790.1	Plateau pour l'arthroscopie de l'épaule
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0266.0	Repose-tête pour chirurgie de l'épaule
101.0364.0	Pièce intermédiaire
101.0019.0	2 x Appui-bras
101.0177.1	Fixe-corps

Arthroscopie du genou

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0212.1	Appui-genou
alternativement :	
101.0583.0	Support de genou
101.0164.0	Fixe-jambe
101.0019.0	Appui-bras
101.0012.0	Arceau d'anesthésie
101.0137.0	Fixe-poignet

Opération de la main/du bras

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes
101.0070.1	Tablette pour interventions sur le bras et sur la main

alternativement à 101.0070.1 :

101.0108.0	Tablette pour interventions sur le bras et sur la main (plateau en matière CFRP)
101.0019.0	Appui-bras
101.0177.1	Fixe-corps
101.0012.0	Arceau d'anesthésie

OPX mobilis® CEMD

Equipement en accessoires recommandé

Traumatologie des membres inférieurs

N° modèle	Description	N° modèle	Description
Modèle de table sans échancrure gyn.		en addition : traitement de fractures du fémur/col du fémur	
101.2580.1	Repose-tête	101.0115.0	Appui-jambe de Göpel
101.0270.1	Dispositif d'extension avec les accessoires de série	101.0146.0	Étaux
	1 x partie de siège avec matelas	101.0193.0	Rallonge du rail latéral
	2 x appuis pour barres d'extension	en addition : traitement de fractures du tibia/fibula	
	2 x plaques de pied pour adultes	101.0280.1	Dispositif de traction de jambe
	2 x guêtres pour adultes	101.0165.0	Clameau d'étrier d'extension
	1 x barre de contretraction, pour la position dorsale	101.0569.0	Fixation condylienne
101.0350.0	Rouleau de contretraction, pour la position latérale	101.0115.0	Appui-jambe de Göpel
101.0748.0	Chariot de transport	101.0146.0	Étaux
101.0218.0	Plateau de jambes pour le transfert	101.0193.0	Rallonge du rail latéral
101.0019.0	Appui-bras	Interventions vertébrales	
101.0012.0	Arceau d'anesthésie	N° modèle	Description
101.0137.0	Fixe-poignet	101.2580.1	Repose-tête
		101.2170.1	Plateaux de jambes
		en positionnement gécubital :	
		101.0682.0	Plateaux supports pour les genoux et les pieds (paire)i
		101.0107.1	2 x Support latéral
		101.0178.0	Support cuisse
		101.0146.0	2 x Étaux
		101.0355.0	Gel coussin position ventrale
		101.0019.0	2 x Appui-bras
		101.0012.0	Arceau d'anesthésie

Neurochirurgie

N° modèle	Description
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes

en décubitus ventral/dorsal :

101.2720.0	Adaptateur universel
101.0113.0	Pièce de raccord DORO
101.0142.0	Support universel DORO
101.0127.0	Support et clameau crânien DORO

Position semi-assise/assise

101.0014.0	Adaptateur universel
101.0018.0	2 x Étaux
101.0113.0	Pièce de raccord DORO
101.0142.0	Joug d'adaptation DORO
101.0127.0	Clameau de crâne DORO
101.0019.0	2 x Appui-bras

alternativement :
Accessoires pour le positionnement de la tête en matériel radiotransparent

Chirurgie des patients obèses


N° modèle	Description
RC 40 model	
101.2580.1	Repose-tête
101.2170.1	Plateaux de jambes

alternativement aux plateaux de jambes :

101.0219.0	Appuis-jambes de Göpel pour patients obèses (paire)
101.0147.0	2 x Étaux
101.0194.0	Éléments d'élargissement (éléments)
101.0200.0	Éléments d'élargissement (éléments)
101.0455.1	Fixe-corps
101.0019.0	2 x Appui-bras
101.2070.1	Plaque d'appui rembourrée

alternativement :

101.0368.0	Plaques de pieds (paire)
101.0010.0	Appui-épaules (1 paire)
101.0164.0	2 x Fixe-jambes

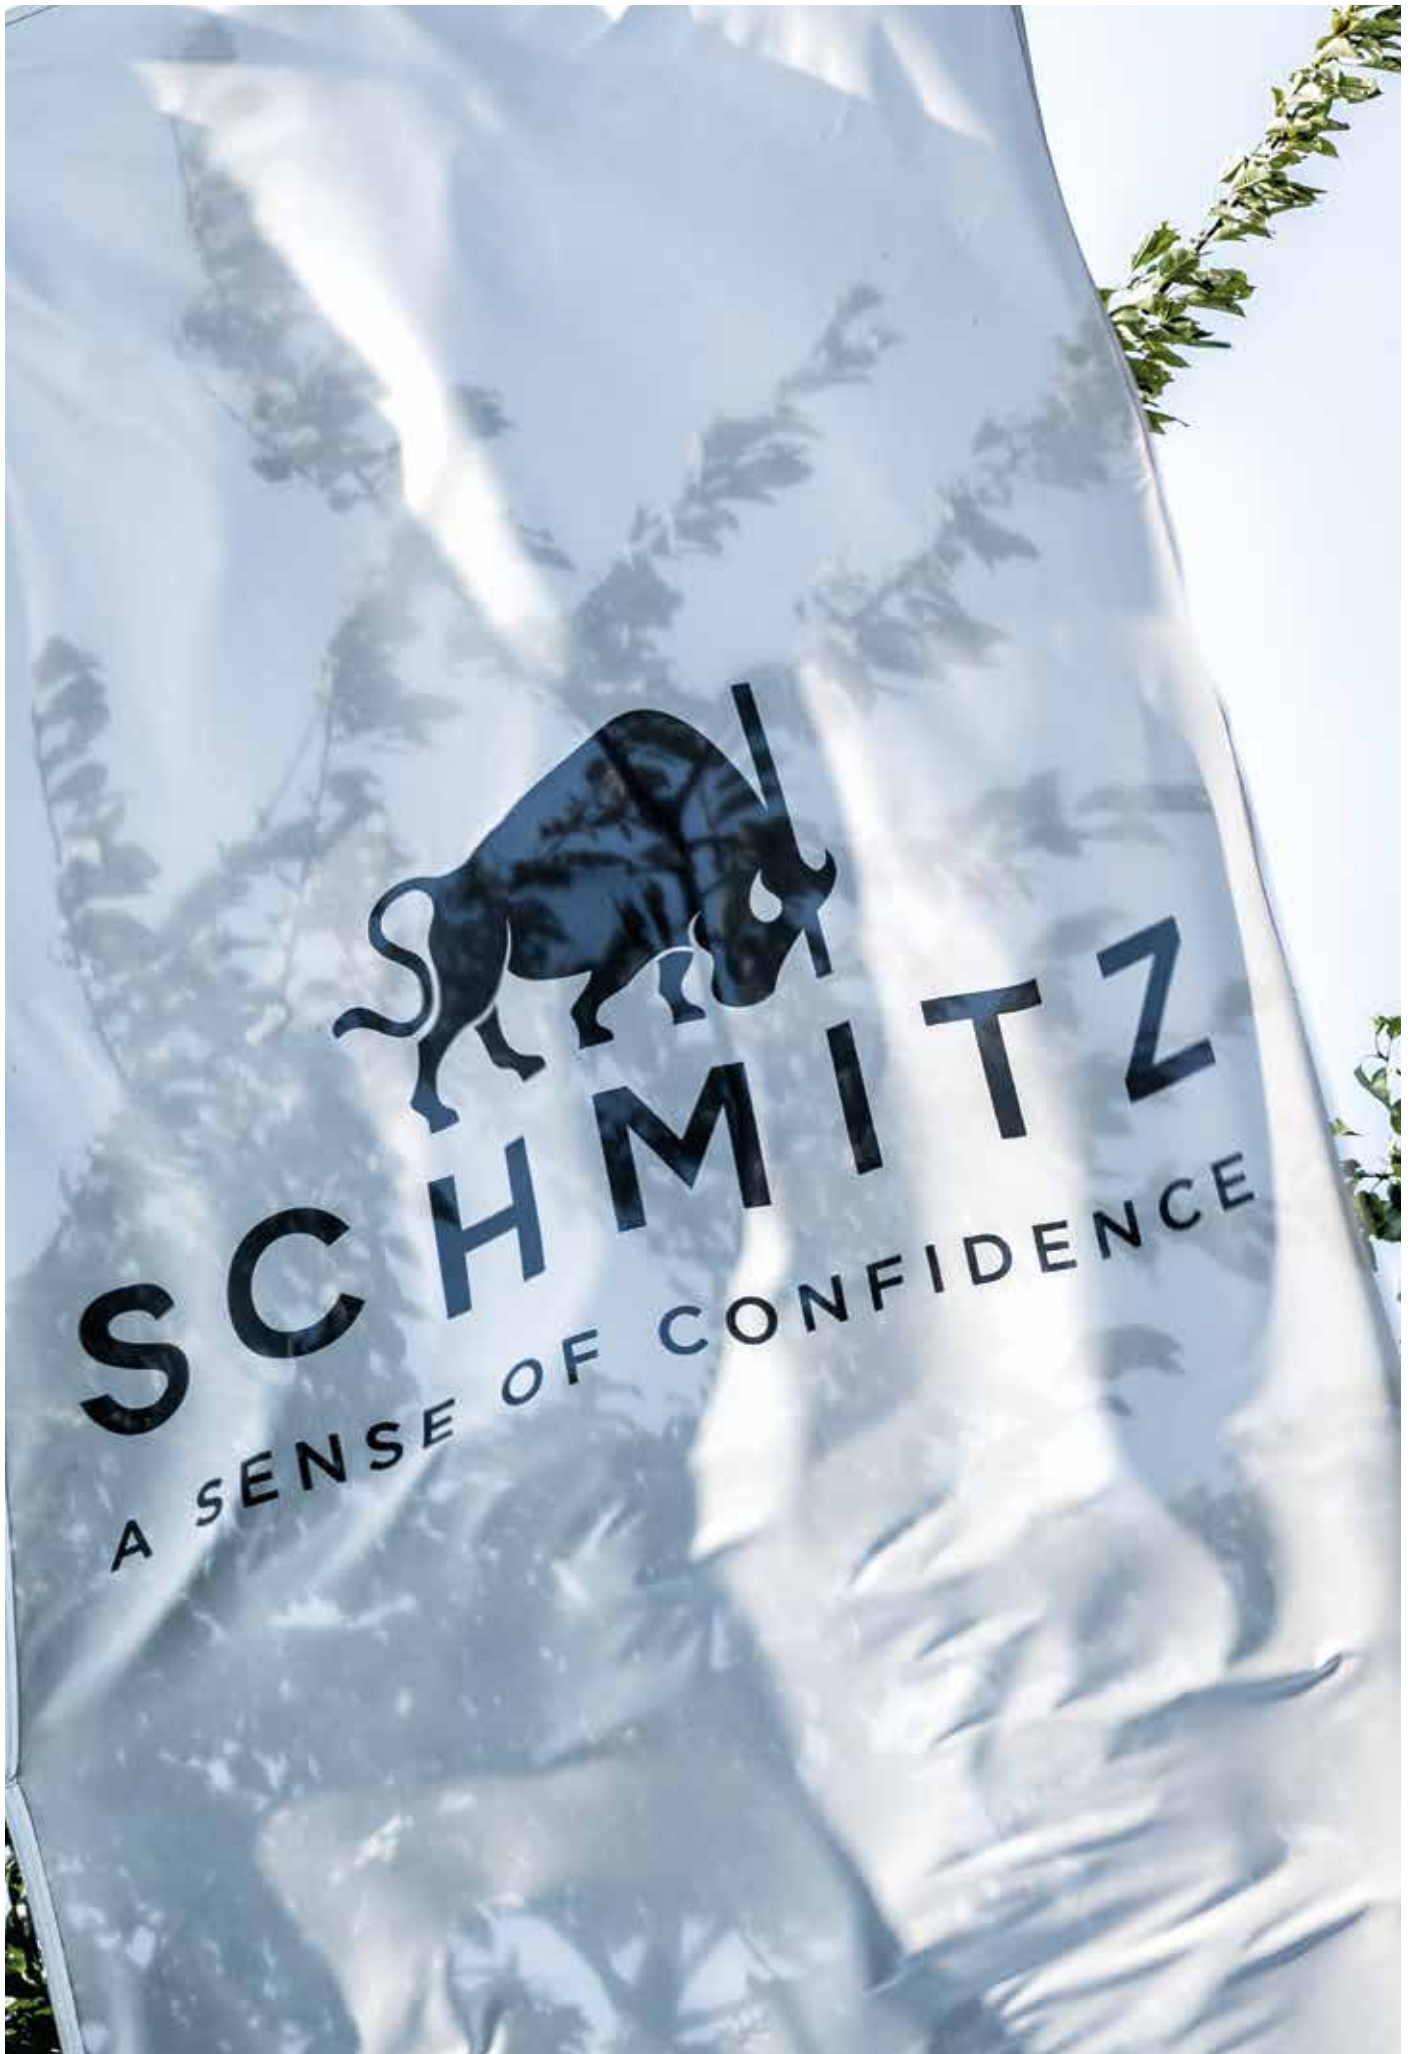

Contact

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne



Tous les dispositifs portant le marquage CE des dispositifs médicaux, en lien avec nos accessoires, se conforment aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu'aux exigences de la loi portant modification de la loi sur les dispositifs médicaux, et sont considérés comme des dispositifs médicaux de la classe de risque I.



Tous les dispositifs portant le simple marquage CE se conforment aux exigences de la Directive basse tension 2014/35/UE ainsi qu'à celles de l'Ordonnance sur le matériel électrique.

Pour connaître les utilisations prévues, veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation !

tél. +49 (0)2377 84 0
télé. +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-medical.com

Département des exportations :
tél. +49 (0)2377 84 0
télé. +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-medical.com

Service technique, hotline :
tél. +49 (0)2377 84 549
télé. +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-medical.com

Visitez notre site internet pour plus d'informations concernant nos agences à l'étranger.

www.schmitz-medical.com



* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les positions de patient présentées dans ce catalogue ne sont qu'exemplaires et ne prétendent pas à l'exactitude et/ou à l'exhaustivité des accessoires, veuillez dans tous les cas respecter les instructions d'utilisation. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.

Prix forfaitaire 3,00 Euro

Catalogue SCHMITZ No. 60, 04.2024 FR